


ISTRUZIONI PER L'USO

TERMOMETRO DIGITALE Termo Flash Clenny® (punta flessibile - schermo retroilluminato)

DESTINAZIONE D'USO:

Il dispositivo **Termo Flash Clenny®** misura la temperatura corporea, attraverso il sensore posto sulla punta di metallo. Per la misurazione della temperatura, questo dispositivo può essere applicato sotto la lingua (misura orale), sotto l'ascella (misura ascellare) e nel retto (misura rettale). Un segnale acustico "Bi, Bi, Bi ..." viene emesso al termine del processo di misurazione di temperatura più rapido. Per garantire a lungo il corretto utilizzo di questo termometro digitale e per la massima soddisfazione del cliente, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e ogni qual volta se ne abbia successivamente necessità.

SCHEMA DELLE PARTI:

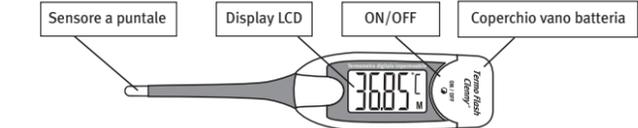

IMPORTANTE:

- Durante la misurazione non camminare, correre o parlare.
- Il termometro deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non conservare il termometro in luoghi dove possa essere esposto alla luce diretta del sole, a polvere o umidità. Evitare l'esposizione a temperature estreme.
- Evitare di far cadere o sottoporre il termometro a forti urti.
- Non smontare il termometro, tranne che per sostituire la batteria.

ATTENZIONE:

- Il termometro contiene piccole parti (ad esempio la batteria), che possono essere inghiottite dai bambini. Pertanto, custodire sempre il termometro in modo da renderlo inaccessibile ai bambini.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di rimuovere la batteria dal suo interno prima di conservarlo in luogo sicuro e protetto.


ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

MISURAZIONE (VIA) RETTALE:

La misurazione della temperatura corporea per via rettale, rappresenta il metodo più accurato da un punto di vista puramente medico, perché il dato ottenuto è quello che si avvicina di più alla reale temperatura corporea interna. La punta del termometro viene inserita con attenzione e delicatamente nel retto per un massimo di 2 cm dopo aver precedentemente applicato sull'orifizio e sulla punta del termometro, una soluzione lubrificante solubile in acqua. Non forzare mai l'inserimento del termometro in caso di resistenza. Mantenere il termometro in posizione sino a quando non viene emesso il segnale acustico di fine misurazione. Il normale tempo di misurazione è di circa **10 secondi**.

MISURAZIONE (VIA) ORALE:


Ci sono zone con diverse emissioni di calore in bocca, quindi, per garantire che la lettura sia il più accurata possibile, posizionare la punta del termometro sotto la lingua, a sinistra o a destra della sua radice.

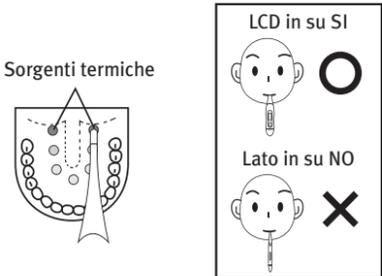

La punta del termometro deve avere un contatto costante con il tessuto durante l'intera durata della misurazione e restare sempre posizionata sotto la lingua in una delle due tasche termiche sulla sua parte più posteriore. Durante la misurazione, tenere sempre la bocca chiusa e respirare normalmente attraverso il naso. Non mangiare o bere nulla prima della misurazione (da almeno 30 minuti prima di iniziare la misurazione). Il normale tempo di misurazione con questo metodo è di circa **10 secondi**.

MISURAZIONE ASCELLARE

Posizionare il termometro sotto l'ascella permette la misurazione della temperatura corporea superficiale. Il normale tempo di misurazione per questo metodo è di circa **10 secondi**. Per ottenere una misurazione quanto più possibile accurata, consigliamo vivamente di posizionare il termometro ancora spento sotto l'ascella per 5/10 secondi e quindi premere il pulsante ON/OFF per avviare la misurazione della temperatura corporea.

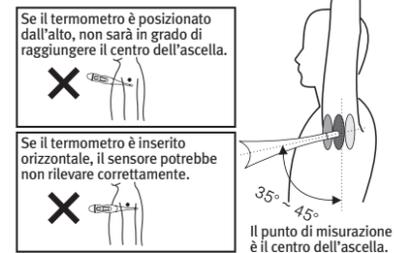

Nota: consigliamo vivamente il metodo rettale come metodo più accurato per identificare la temperatura basale.

Suggerimento: per ottenere una lettura ancor più accurata, posizionare il termometro ancora spento nel sito di misurazione prescelto (ascella/orale/rettale), quindi premere il pulsante ON/OFF per avviare la misurazione della temperatura corporea.

FUNZIONAMENTO:

- Premere il pulsante ON/OFF per accendere il termometro. Di seguito, un breve segnale acustico indica che il termometro è acceso e contemporaneamente, il display si accende visualizzando tutti i simboli e indicazioni grafiche contenute.
- Il termometro è pronto per essere applicato e utilizzato quando sullo schermo rimane visibile il simbolo "Lo" e l'indicazione "°C" lampeggiante.

Note: In presenza di una temperatura ambientale inferiore a 32.00 °C il dispositivo visualizza il simbolo "Lo °C", mentre in caso di una temperatura ambientale superiore a 42.99 °C visualizza il simbolo "Hi °C", in entrambi i casi senza attivarsi per la misurazione.

Durante l'intera durata della misurazione, lo schermo visualizza il valore termico ottenuto al momento e il simbolo "°C" continua a lampeggiare. La misurazione è completata quando viene raggiunto un livello di temperatura registrata pressoché costante. La fine della misurazione viene segnalata con un allarme sonoro "beep" ripetuto 10 volte e nel contempo il valore più elevato di temperatura registrato appare sullo schermo.

Per prolungare la durata della batteria, alla fine di ogni utilizzo, spegnere sempre il termometro premendo nuovamente il pulsante ON/OFF. In caso contrario il termometro si spegnerà automaticamente dopo circa 5 minuti.

IMPOSTAZIONE FUNZIONE AUDIO:

È possibile attivare/disattivare la funzione audio. Con dispositivo spento, tenere premuto il pulsante ON/OFF sino quando lo schermo visualizza il segno "ON", quindi rilasciare il pulsante. Premere nuovamente il pulsante e verrà visualizzata l'indicazione "OFF", ad indicazione del fatto che la funzione sonora è disattivata. Ripetere l'operazione per riattivarla.

FUNZIONE MEMORIA:

- Premere il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo. L'ultimo valore di temperatura misurato dal dispositivo viene visualizzato automaticamente sullo schermo insieme al simbolo "M".
- A questo punto è possibile procedere con una nuova misurazione oppure spegnere il dispositivo premendo nuovamente il pulsante ON/OFF.
- Il valore registrato in memoria viene automaticamente sovrascritto ogni volta che si avvia una nuova misurazione.

FUNZIONE INTERFACCIA LUMINOSA:

Il dispositivo è dotato di un display con tre differenti retroilluminazioni che si accendono al termine della misurazione in base alla temperatura rilevata, fornendo un immediato messaggio di corrispondenza all'utilizzatore. Di seguito i range termici corrispondenti ad ogni colore e la relativa interpretazione febbrile:

COLORE DISPLAY	TEMP CORRISP.
VERDE	36.00 ÷ 37.29 °C
BLU	32.00 ÷ 35.99 °C 37.30 ÷ 37.99 °C
ROSSO	38.00 ÷ 42.99 °C

Indipendentemente dal sito di misurazione, il colore VERDE del termometro indica una temperatura rilevata NORMALE, mentre il colore ROSSO, indica una temperatura rilevata indice di stato febbrile più o meno elevato. L'accensione del colore blu indica invece una lettura molto bassa (ipotermia o possibile errore di misurazione) o di una condizione di potenziale stato febbrile in funzione del sito dove la misura è stata effettuata (una temperatura di 37.6°C è indice di stato febbrile in caso di misurazione ascellare o orale, ma non in caso di misurazione rettale).

TEMPERATURA CORPOREA:

La normale temperatura corporea varia nell'uomo entro uno specifico intervallo. La tabella seguente mostra che l'intervallo di normalità dipende dal metodo di misurazione e varia quindi in funzione di quest'ultimo. Per questo motivo, l'interpretazione del risultato ottenuto deve essere fatta in funzione della zona del corpo dove è stato ottenuto e può essere confrontato con le misurazioni ottenute in altre zone del corpo.

Intervallo di Temperatura Corporea considerati normali in °C	
ASCELLA	34.7 - 37.3
ORALE	35.5 - 37.5
RETTALE	36.6 - 37.7

Tuttavia, l'intervallo normale di una persona è soggetto ad altre variabili che ne possono definire lievi variazioni. Pertanto, è importante che ogni individuo determini in autonomia il rispettivo intervallo di normalità. In tal senso, eseguire la misurazione della temperatura corporea propria o di altri membri della famiglia, in condizioni ideali di buona salute, permette di determinare l'intervallo di normale temperatura corporea per ciascun individuo.

PULIZIA E DISINFEZIONE:

Al fine di prevenire infezioni, il termometro deve essere pulito accuratamente dopo ogni utilizzo. Pertanto raccomandiamo l'uso di disinfettanti disponibili in commercio (ad es. Una soluzione delicata contenente alcool).

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:


Sostituire la batteria quando il simbolo di Batteria Scarica viene visualizzato sullo schermo indicando un basso livello di carica.

Utilizzare solo batterie a bottone da 3.0 V DC, tipo CR1632

1. Posizionare il termometro con la parte posteriore rivolta verso l'alto ed estrarre il coperchio della batteria premendolo leggermente verso il basso e nel contempo tirandolo verso l'esterno. Attenzione, durante questa operazione la batteria potrebbe cadere a terra facilmente in caso appliciate una eccessiva energia.



2. Estrarre il supporto batteria e la batteria utilizzando un piccolo attrezzo e sostituirla con una nuova e del tipo sopra indicato.



3. Riposizionare prima il supporto interno e poi il coperchio della batteria, nel senso corretto assicurandosi che si sia bloccato nella propria sede in modo corretto.



ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:

Questo dispositivo non necessita di particolari procedure di manutenzione durante la sua vita prevista, ad eccezione della sostituzione della batteria. L'aspettativa di vita di questo dispositivo è di 3 anni dalla data di fabbricazione o 2 anni dalla data di primo utilizzo (senza batterie all'interno e nel rispetto dei limiti delle condizioni di conservazione). Dopo questo periodo, si consiglia di utilizzare il dispositivo dopo una verifica di accuratezza effettuato da un istituto di terza parte qualificato.

SPECIFICHE:

Modello:	Termo Flash Clenny®
Display:	LCD, 4,5 digits, 23,5mm x 15,5mm, retroilluminato a tre colori
Misurazione termica tramite:	Termistore
Applicabile per via:	Rettale/Orale/Ascellare
Tempo di misurazione:	10 secondi
Campo di misurazione:	32.00 °C ~ 42.99 °C
Accuratezza:	+/- 0.1 °C da 35.5 °C a 42 °C +/- 0.2 °C nel rimanente range di misurazione
Risoluzione:	0.01 °C
Memorie:	1
Indicatore batteria scarica:	SI
Funzione spegnimento automatico:	SI (dopo circa 5 minuti)
Alimentazione e tensione:	Batteria a bottone 3.0 V DC, tipo CR1632
Durata delle batterie:	Circa 600 misurazioni o 2 anni
Dimensioni:	135mm x 28mm x 10mm
Peso:	Circa 16g incluso le batterie
Condizioni ambientali operative:	Temperatura da 5°C a 40°C; Umidità Relativa: 15% RH ~ 85% RH; Pressione Atmosferica: 70KPa ~ 106KPa
Condizioni Ambientali di trasporto e stoccaggio	Temperatura da -20°C a 55°C; Umidità Relativa: 10%RH ~ 85%RH; Pressione Atmosferica: 70KPa ~ 106KPa

* In caso di modifica delle specifiche, le stesse verranno applicate senza preavviso.

SIMBOLOGIA UTILIZZATA

1		ATTENZIONE!
2		MANTENERE ASCIUTTO
3		Leggere le istruzioni prima dell'uso
4		Dispositivo con Parte Applicata Tipo BF
5		Grado di protezione di un'apparecchiatura elettrica contro la penetrazione accidentale o intenzionale di corpi solidi estranei, e protezione alla penetrazione di liquidi. 1° Cifra - Protetto contro polveri (nessun deposito nocivo) 2° Cifra - Protetto contro i getti d'acqua da tutte le direzioni
6		Batteria scarica
7		DATA DI FABBRICAZIONE
8		FABBRICANTE

CA-MI Srl Via Ugo La Malfa, 13 - Frazione Pilastrò - 43013 Langhirano (PR) Italy
Questo dispositivo è fabbricato in Cina

Distributore: Chiesi Italia S.p.A. Via G. Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR) Italia

IL TERMOMETRO È STATO PROGETTATO E REALIZZATO IN CONFORMITÀ AI SEGUENTI STANDARD EUROPEI:

IEC 60601-1	Apparecchiature elettriche mediche - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali
IEC 60601-1-2	Apparecchiature elettriche mediche - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Standard collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Requisiti e prove
ISO 80601-2-56	Apparecchiature elettromedicali - Parte 2-56: requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei termometri clinici per la misurazione della temperatura corporea

ISO 15223-1 Dispositivi medici - simboli da utilizzare con le etichette dei dispositivi medici, l'etichettatura e le informazioni da fornire - parte 1: requisiti generali

Il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE (e s.m.i.)

Compatibilità elettromagnetica:

Il dispositivo è conforme allo standard IEC 60601-1-2 per la compatibilità elettromagnetica. Non lasciare che il termometro diventi la fonte del disturbo, prova anche a evitare la fonte del disturbo. Richiedere al produttore per i dettagli su questi dati di misurazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di progettazione nel corso del miglioramento continuo del prodotto.

AVVERTENZE!

- Questo dispositivo non deve esse riutilizzato in prossimità o sulla parte superiore di altre apparecchiature elettroniche come telefoni cellulari, ricetrasmittitori o radiocomandi. In tal caso, è necessario osservare il dispositivo per verificare il normale funzionamento.
- L'uso di accessori e cavi di alimentazione diversi da quelli specificati, ad eccezione dei cavi venduti dal produttore dell'apparecchiatura o del sistema come pezzi di ricambio per componenti interni, può comportare un aumento delle emissioni o una riduzione dell'immunità dell'apparecchiatura o del sistema.

Garanzia	
Questo prodotto è coperto da garanzia per 2 anni a partire dalla data di acquisto. I danni causati dall'utilizzo scorretto non sono coperti da garanzia. La batteria e la confezione sono escluse dalla garanzia. Se il termometro è difettoso e non funziona correttamente, si raccomanda di controllare la batteria prima di inviarlo per la riparazione. La garanzia è nulla in caso di manomissione, se il difetto è causato da un utilizzo improprio o se il danno non è dovuto a difetti di fabbricazione (caduta accidentale, trasporto inaccurato, ecc.). La garanzia è valida dalla data di acquisto e solo se certificata da fattura, ricevuta o scontrino fiscale. Per il servizio di ASSISTENZA TECNICA, contattare il NUMERO VERDE	



AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE-RAEE: Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure riconsegnarlo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Il simbolo posto all'interno dell'etichetta dati indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Attenzione: Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.



TRATTAMENTO DELLE PILE ESAUSTE (Direttiva 2006/66/CE): Questo simbolo sul prodotto indica che le pile non devono essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurarsi che le pile siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle pile esauste o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato l'apparecchio.


OPERATING INSTRUCTIONS

Termo Flash Clenny® (rigid tip with backlight LCD) DIGITAL THERMOMETER

INTENDED USE:

Device **Termo Flash Clenny®** measures body temperature, which is measured at the metal measuring tip. This digital thermometer can be used under the tongue (oral), in the armpit (axillary) and in the rectum (rectal) to take temperature measuring results. An acoustic signal in "Bi, Bi, Bi..." will beep out once the temperature measuring process is complete. To ensure the best results and long-term satisfaction with this Digital Thermometer, we recommend that you read the instruction carefully before use and every time you will need in the future.

SCHEMATIC DIAGRAM:

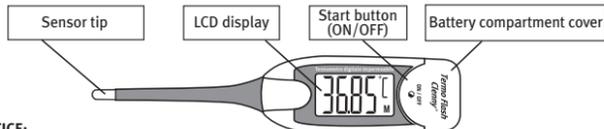

NOTICE:

- During the measurement, do not walk, run or talk.
- The thermometer should only be used under the supervision of an adult.
- Do not store the thermometer where it will be exposed to direct sunlight, dust or humidity. Avoid extreme temperature.
- Dropping or subjecting your thermometer to strong shocks should be avoided.
- Do not disassemble the thermometer, except to replace the battery.

CAUTION:

- The thermometer contains small parts (e.g. battery), which could be swallowed by children. Therefore, keep the thermometer inaccessible for children.
- If the device will not be used for an extended period of time, make sure you remove the battery when you store it.

OPERATING INSTRUCTION



RECTAL (WAY) MEASUREMENT:

This is the most accurate method from a medical point of view, because it comes closest to the core body temperature. The thermometer tip is inserted carefully into the rectum for a maximum of 2 cm, after having previously applied a water-soluble lubricating solution to the orifice and the tip of the thermometer. Never force the insertion of the thermometer in case of resistance. Keep the thermometer in position until the end measurement beep alarm is emitted. **The usual measuring time is approximately 10 seconds.**

ORAL (WAY) MEASUREMENT

There are different heat zones in the mouth. To ensure that reading is as accurate as possible, place the thermometer tip to the left or right of the root of the tongue. The thermometer tip must have constant contact with the tissue during the reading and be placed under the tongue in one of the two heat pockets at the back. Keep the mouth closed during the reading and breathe evenly through the nose.


Heat pocket



Do not eat or drink anything before the measurement (30 minutes before do the measurement at least). **The usual measuring time is approximately 10 seconds.**

AXILLARY MEASUREMENT:

Placing the thermometer in the armpit provides a measurement of surface temperature. The usual measuring time for this method is **approximately 10 seconds**. For getting the more accurate measuring result, we strong recommend to put the thermometer still OFF under armpit for 5/10 seconds, then press ON/OFF button to start with measurement of body temperature.

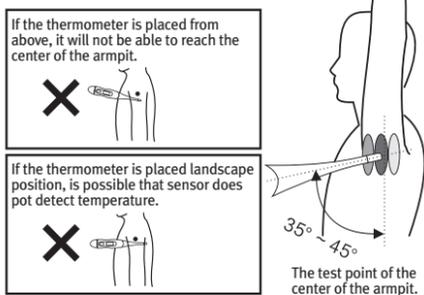

Note: We strongly recommend the rectal method as the most accurate method for identifying the basal temperature.

Prompts: To obtain more accurate reading, place the thermometer at the measurement site (armpit/oral/rectal) firstly, then press the ON/OFF button to start the body temperature measurement.

OPERATING:

- Press the ON/OFF button to turn on the thermometer. After a short beep indicates that the thermometer is now switched on. Simultaneously, a test display is performed in which all the symbols to illuminate the display. 
- The thermometer is ready to use when the "Lo" and a flashing "°C" appears in the display.

Notes: In an ambient temperature below 32.00 °C will show "Lo °C," appears in an ambient temperature above 42.99 °C "Hi °C".

During the measurement, the current temperature will be displayed continuously. During this period, the symbol "°C" blinks. The measurement is ended when a constant temperature is reached. The end of the measurement signal 10 beeps. The highest measured temperature is displayed.

To extend battery life, turn off the thermometer after use by pressing the ON /OFF button again. Otherwise the thermometer will automatically turn off after approximately 5 minutes.

SOUND FUNCTION SETTING:

The sound function is available to be turn ON/OFF. With the unit is off, press and hold the ON/OFF button until when the screen displays "ON" mark and let go of button. After it, press the button again to display "OFF" mark on LCD. This mean the sound is turn off. Repeat this operation to activate it again.

MEMORY FUNCTION:

- Press the ON/OFF button to turn on the thermometer. The last measured temperature is automatically saved is displayed. The temperature appears with a small "M" in the display.
- You can now perform another measurement or turn off the power with the ON/OFF button.
- The stored value is automatically overwritten when a new measurement is started.

LUMINOUS INTERFACE FUNCTION:

This device is equipped with a 3 colours backlights LCD that light up at the end of each measurement with a colour that depends by detected temperature, providing an immediate correspondence message to the user. Below are the body temperature ranges corresponding to each color and the corresponding feverish state interpretation:

BACKLIGHT COLOUR	Temperature Measurement range
GREEN	36.00 ÷ 37.29 °C
BLUE	32.00 ÷ 35.99 °C 37.30 ÷ 37.99 °C
RED	38.00 ÷ 42.99 °C

Regardless of the measurement site, the backlight GREEN color at the end of measurement indicates always a NORMAL measured temperature, while the RED color indicates always a detected temperature index of febrile state more or less high. The turning on of the blue color indicates instead a very low reading (hypothermia or possible error of measurement) or of a condition of potential febrile state depending on the site where the measurement was carried out (a temperature of 37.6 °C is index of febrile state in case of axillary or oral measurement, but not in case of rectal measurement).

BODY TEMPERATURE:

Normal body temperature varies within a certain range. The following table shows the normal range depends on the measurement method. Therefore, measurement results can be directly compared different measuring points either.

Normal temperature ranges in °C	
AXILLA	34.7 - 37.3
ORAL	35.5 - 37.5
RECTAL	36.6 - 37.7

However, the normal range of a persons subject to other slight variations. Therefore, it is important to determine the respective normal range for your self. Run the temperature measurement by yourself and other family members from - ideally in a healthy state - to determine the normal range for each individual.

CLEANING AND DISINFECTION:

To prevent infections the thermometer should be cleaned thoroughly after each use. We therefore recommend the use of commercially available disinfectants (e.g. a mild solution containing alcohol).


BATTERY REPLACEMENT:

Replace the battery when the battery level indicator  shows low battery status.


USE ONLY BUTTON BATTERIES 3.0 V DC, type CR1632

BATTERY REPLACEMENT:

- Place the thermometer with face back up and pull-out the battery cover by pressing it slightly downwards and at the same time pulling it outwards. CAUTION, during this operation the battery could fall to the ground easily if you apply excessive energy.



- Take out the battery by a tool and replace it with a new one



- Put back the battery holder and battery cover in the right direction and make sure that it is properly locked in place.



INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE:

This device doesn't need of particular procedures of maintenance during its expected life except that battery replacement. Life expectation for this device is 3 years from the manufacturing data or 2 years from first use data (without batteries contained and in respect of storage conditions limits). After this period, is recommended to use device after an accuracy check done from qualified third part institute.

SPECIFICATIONS:

Model No.:	Termo Flash Clenny®
Display:	LCD, 4,5 digits, 23,5mm x 15,5mm with 3 colours backlight
Temperature measurement:	Thermistor
Apply for:	Rectal/Oral/Axillary
Temperature measuring time:	10 seconds
Measuring range:	32.00 °C ~ 42.99 °C
Accuracy:	+/- 0.1 °C from 35,5 °C to 42 °C +/- 0.2 °C in the rest measuring range
Resolution:	0.01 °C
Memory records:	1 set
Law voltage indication:	YES
Automatically turn-off function:	YES (after 5 minutes)
Power source and voltage:	DC 3.0 V button batteries, type CR1632
Battery life:	Approx. 600 times or 2 years
Dimension:	135mm x 28mm x 10mm
Unit weight:	Approx. 16g including battery
Work environment:	Temperature 5°C to 40°C; Humidity: 15% RH ~ 85% RH; Atmospheric pressure: 70KPa ~ 106KPa
Transport/Storage condition:	Temperature -20°C a 55°C; Humidity: 10%RH ~ 85%RH; Atmospheric pressure: 70KPa ~ 106KPa

* If there is any specification change for the product, these will be applied without prior notice.

SYMBOL EXPLANATION:

1		Caution
2		Keep dry
3		Read the instruction before use
4		Type BF Applied Part Device
5	IP55	Degree of protection of an electrical device against accidental or intentional penetration of foreign solid bodies, and protection against the penetration of liquids. 1 st Number - Protected against dust (no harmful deposit) 2 ^o Number - Protected against low pressure jets of water from all directions
6		Law battery status
7		Date of Manufacturer
8		Manufacturer

 **CA-MI Srl** Via Ugo La Malfa, 13 - Frazione Pilastro - 43013 Langhirano (PR) Italy
This product is MADE IN CHINA

Distributor: Chiesi Italia S.p.A. Via G. Chiesi, 1 - 43122 Parma (Italy)

THE THERMOMETER WAS DESIGNED AND MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING EUROPEAN STANDARDS:

IEC 60601-1	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
IEC 60601-1-2	Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility Requirements and tests
ISO 80601-2-56	Medical electrical equipment - Part 2-56: particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers body temperature measurement
ISO 15223-1	Medical devices - symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements

This product complies with the European Directive for Medical Devices 93/42/EEC and carries the CE mark.

Electromagnetic compatibility:

The device complies with the IEC 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility. Please do not let thermometer become source of the disturbance, also try your best avoid source of the disturbance. Inquire at the Manufacturer for details on this measurement data. We reserve the right to make technical and design changes in the course of continuous product improvement.

WARNINGS!

- This device should not be used in the vicinity or on the top of other electronic equipment such as cell phone, transceiver or radio control products. If you have to do so, the device should be observed to verify normal operation.
- The use of accessories and power cord other than those specified, with the exception of cables sold by the manufacturer of the equipment or system as replacement parts for internal components, may result in increased emissions or decreased immunity of the equipment or system.

Warranty

This product is covered by warranty for 2 years from the date of purchasing. Damage resulting from incorrect use or abuse is not covered by the warranty. Battery and packaging are excluded from the warranty. If you find that the thermometer is defective and not operating correctly, please firstly check the battery before sending in for repair. Warranty is voided in case of tampering, if the defect is caused by improper use or if the damage is not due to manufacturing faults (accidental drop, inaccurate transportation, etc.). Warranty is valid from date of purchasing (certified from invoice or receipt).

For the TECHNICAL ASSISTANCE service, contact the TOLL-FREE NUMBER

 **800.005.525**



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC

DIRECTIVE 2012/19/UE-WEEE: The symbol on the device indicates the separated collection of electric and electronic equipment. At the end of life of the device, don't dispose it as mixed solid municipal waste, but dispose it referring to a specific collection center located in your area or returning it to the distributor, when buying a new device of the same type to be used with the same functions. This procedure of separated collection of electric and electronic devices is carried out forecasting a European environmental policy aiming at safeguarding, protecting and improving environment quality, as well as avoiding potential effects on human health due to the presence of hazardous substances in such equipment or to an improper use of the same or of parts of the same. Caution: The wrong disposal of electric and electronic equipment may involve sanctions.



DISPOSAL OF SPENT BATTERIES (Directive 2006/66/EC): This symbol on the product indicates that the batteries should not be treated as household waste. Ensuring that the batteries are correctly disposed of contributes to preventing potential negative consequences for health and the environment, which could otherwise be caused by their inappropriate disposal. Recycling materials helps to preserve our natural resources. Take the spent batteries to collection points for recycling. For more information about collection and recycling of spent batteries or the product, please contact your Municipality, your local waste disposal service or the shop where you purchased the device.